
FUJIFILM
Value from Innovation



Videobroncoscopio

EB-840S

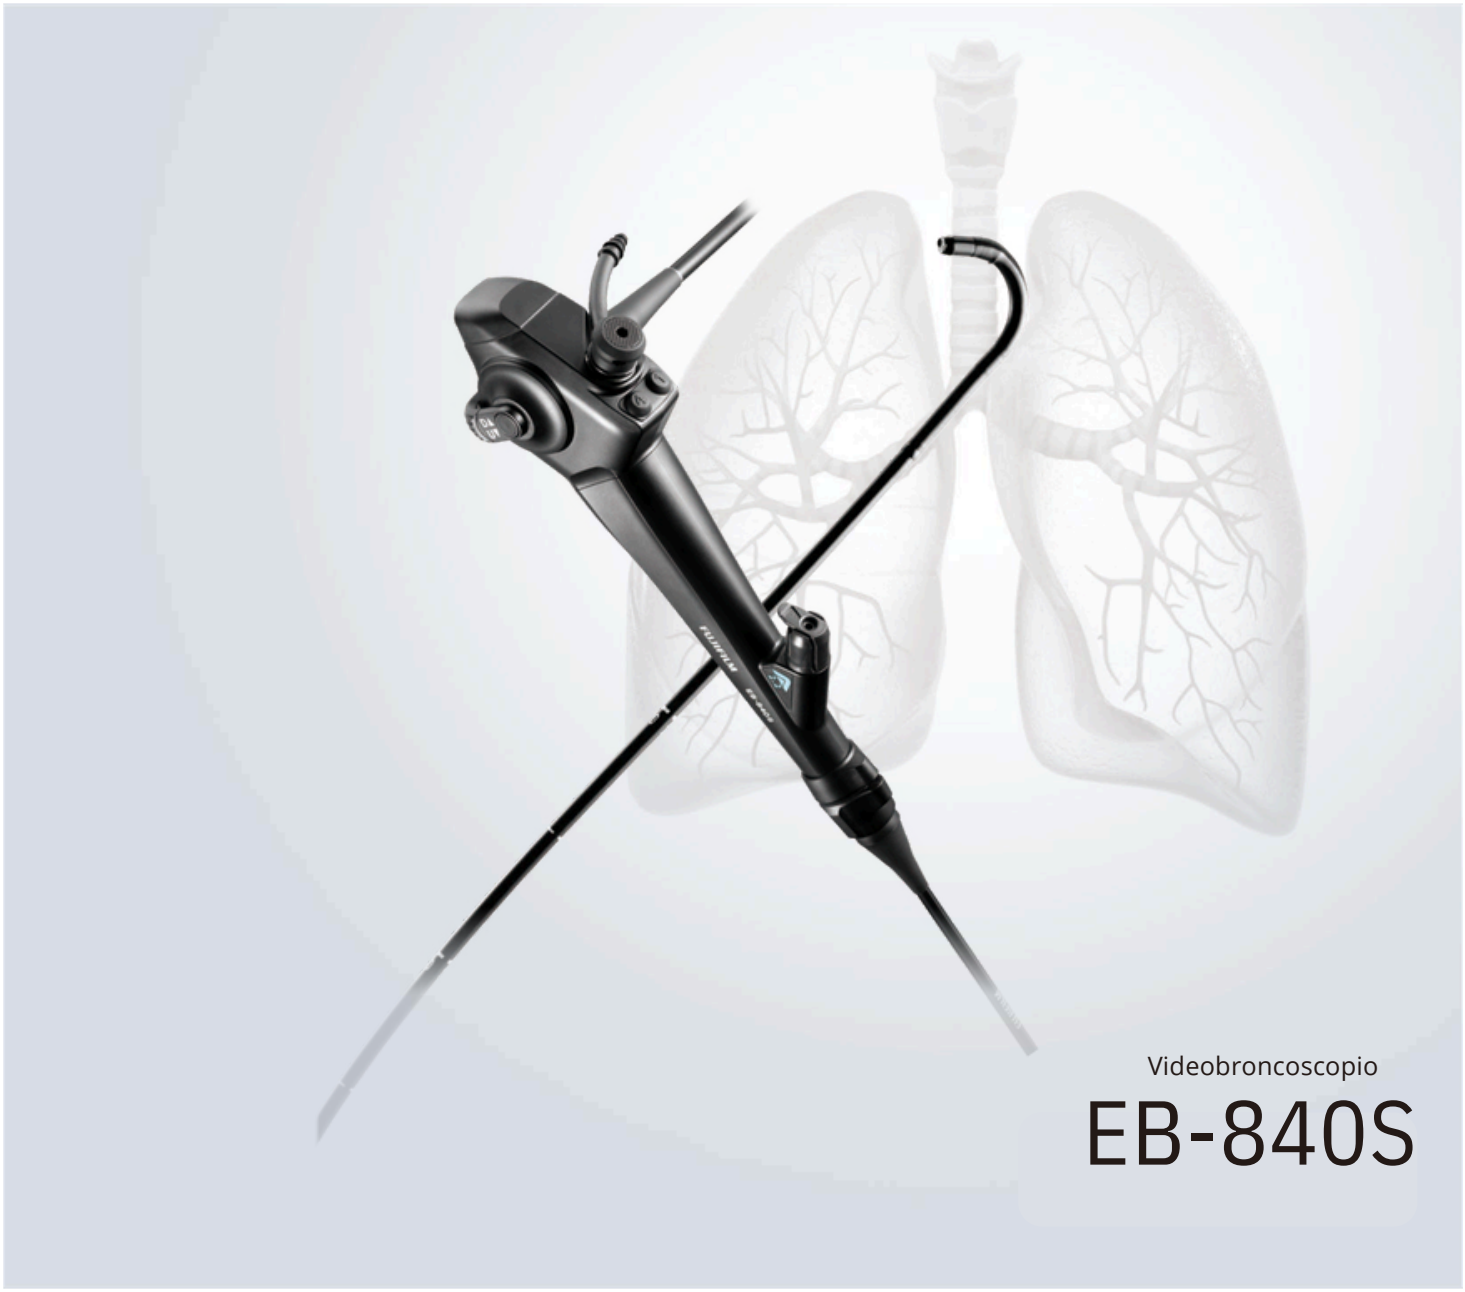


Videobroncoscopio EB-840S


Tipo estándar

Se ha logrado una alta calidad de imagen mediante la incorporación de un sensor CMOS de alta definición (HD)

Las imágenes endoscópicas de alta calidad se muestran en gran tamaño en el monitor para facilitar una inserción, observación y tratamiento fluidos.

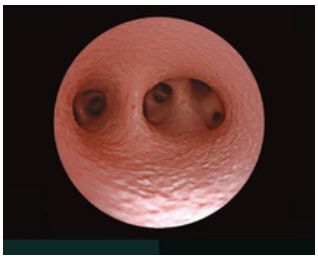


*EB-580T con VP-7000 y BL-7000

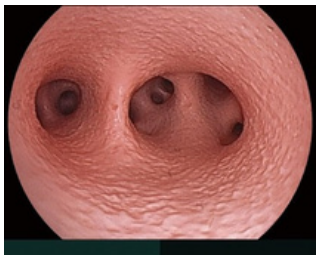

*EB-840T con VP-7000 y BL-7000


Reducción de 0.5 mm en el diámetro del extremo distal

Manteniendo el mismo rendimiento de succión que el modelo anterior, se ha reducido el diámetro de la punta para mejorar la inserción en los bronquios

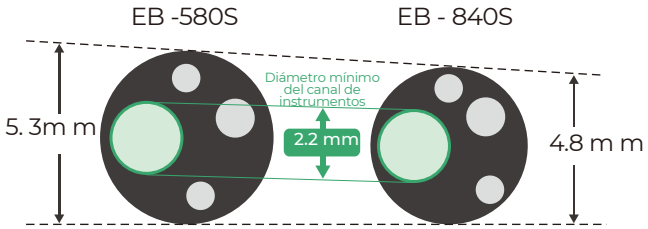

Función de rotación

Hacer coincidir las formas de los relieves del índice y del anillo de rotación ayuda a identificar el centro de rotación.

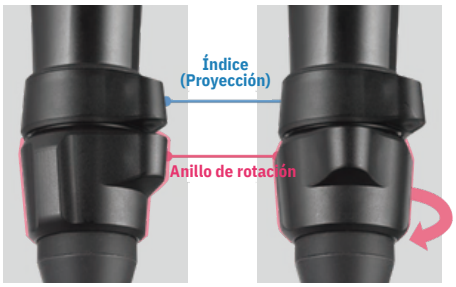

Posición central

Rotación de 120 grados

Sección de control mejorada con una ergonomía optimizada

Sección de control equipada con un agarre más amplio, válvula de succión y 4 interruptores.



Conector de un solo paso

Puede conectarse a la fuente de luz o al procesador en un solo paso, sin necesidad de cables adicionales.



Tecnología LCI / BLI

Tecnología LCI (Linked Color Imaging)

El aumento del contraste en el espectro del color rojo mejora la visibilidad de los cambios en la mucosa.

Tecnología BLI (Blue Light Imaging)

La manipulación de las longitudes de onda de la luz permite obtener imágenes con un contraste mejorado.

Sistema compatible

Procesador EP-8000	Nombre del producto: Procesador GMDN: 34540 Nombre genérico: Sistema de procesamiento de imagen de video endoscópico / fuente de luz
Procesador VP-7000	Nombre del producto: Procesador GMDN: 18034 Nombre genérico: Unidad de procesamiento de imagen de video endoscópico
Fuente de luz BL-7000	Nombre del producto: Fuente de luz GMDN: 35158 Nombre genérico: Unidad de fuente de luz endoscópica, alimentada por red eléctrica
Procesador EP-6000	Nombre del producto: Procesador GMDN: 34540 Nombre genérico: Sistema de procesamiento de imagen de video endoscópico / fuente de luz

Esterilización


Compatible con la esterilización por plasma a baja temperatura*.


* STERRAD® Sistemas suministrados por Advanced Sterilization Products, Inc.


Especificaciones

Campo de visión	120°
Rango de observación	2 a 100 mm
Diámetro del extremo distal	4.8 mm
Diámetro del tubo de inserción	5.1 mm
Diámetro mínimo del canal de instrumentos	2.2 mm
Capacidad de flexión	HACIA ARRIBA 210°/ HACIA ABAJO 130°
Longitud de trabajo	600 mm
Longitud total	880 mm
Esterilización	STERRAD/ EOG

Nombre del producto: Videobroncoscopio GMDN: 17662
Nombre genérico: Videobroncoscopio flexible, reutilizable







Dirección de fórceps

FUJIFILM y el logotipo de FUJIFILM son marcas registradas o marcas comerciales de FUJIFILM Corporation.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

26-30, NISHIAZABU 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 106-8620, JAPAN
http://www.fujifilm.com/

Z11-N200993